




■ 特性:


- 国际通用全范围交流输入
- 低漏电流<250 μ A
- 保护种类: 短路/过负载/过电压
- 自然风冷
- 通过医疗类安规认证(2级MOPP患者保护措施)
- 100%满载老化
- 开关工作频率: 45KHZ
- 3年保固

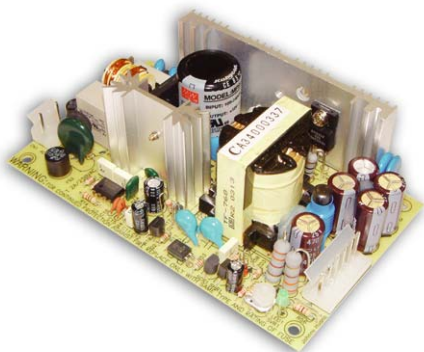

电气规格

型号		MPT-65A			MPT-65B			MPT-65C		
输出	输出通道	CH1	CH2	CH3	CH1	CH2	CH3	CH1	CH2	CH3
	直流电压	5V	12V	-5V	5V	12V	-12V	5V	15V	-15V
	额定电流	5.5A	2.5A	0.5A	5.5A	2.5A	0.5A	5.5A	2A	0.5A
	电流范围	0.4 ~ 7A	0.2 ~ 3.2A	0 ~ 0.7A	0.4 ~ 7A	0.2 ~ 3.2A	0 ~ 0.7A	0.4 ~ 7A	0.2 ~ 2.6A	0 ~ 0.7A
	额定功率	60W			63.5W			65W		
	输出功率 (最大)	72W强制散热, 风量大于18CFM								
	纹波与噪声 (最大) 备注2	60mVp-p	120mVp-p	60mVp-p	60mVp-p	160mVp-p	100mVp-p	60mVp-p	180mVp-p	100mVp-p
	电压调整范围	CH1:4.5 ~ 5.5V								
	电压精度 备注3	±4.0%	+10,-7%	±5.0%	±4.0%	+10,-7%	±5.0%	±4.0%	+10,-7%	±5.0%
	线性调整率	±1.0%	±2.0%	±1.0%	±1.0%	±2.0%	±1.0%	±1.0%	±2.0%	±1.0%
	负载调整率	±3.0%	±4.0%	±1.0%	±3.0%	±4.0%	±1.0%	±3.0%	±4.0%	±1.0%
	启动、上升时间	800ms, 20ms/230VAC 800ms, 20ms/115VAC(满载时)								
保持时间 (Typ.)	80ms/230VAC 12ms/115VAC(满载时)									
输入	电压范围	90 ~ 264VAC或127 ~ 370VDC								
	频率范围	47 ~ 63Hz								
	效率 (Typ.)	74%			74%			74%		
	交流电流 (Typ.)	1.6A/115VAC 1A/230VAC								
	浪涌电流 (Typ.)	冷启动: 20A/115VAC 40A/230VAC								
	漏电流 备注7	对地漏电流 < 250μA/264VAC, 接触电流 < 60μA/264VAC								
保护	过负载	73~95W 保护模式:打嗝模式, 负载异常条件移除后可自动恢复								
	过电压	CH1: 5.75 ~ 6.75VDC 保护模式:打嗝模式, 电压异常条件移除后可自动恢复								
环境	工作温度	-10~+55℃ (请参考“减额曲线”)								
	工作湿度	20 ~ 90% RH,无冷凝								
	储存温度、湿度	-20 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH								
	温度系数	±0.04%/℃ (0 ~ 50℃) (+5V)								
	耐振动	10 ~ 500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟								
安规和电磁兼容 (备注4)	安全规范	ANSI/AAMI ES60601-1, TUV EN60601-1, IEC60601-1认证通过								
	绝缘防护等级	一次侧-二次侧:2xMOPP, 一次侧-接地:1xMOPP								
	耐压	I/P-O/P:4KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC 1min.								
	绝缘阻抗	I/P-O/P, I/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH								
	电磁兼容发射	符合EN55011 (CISPR11) Class B, EN61000-3-2,-3								
	电磁兼容抗扰度	符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN60601-1-2,A级医疗标准								
其它	MTBF	≥275.1K hrs. MIL-HDBK-217F (25℃)								
	尺寸	127*76*42mm (L*W*H)								
	包装	0.27Kg; 54pcs/16.8Kg/1.35CUFT								
备注	1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1uf和47uf的电容, 在20MHZ带宽下进行量测。 3. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 电源应视为系统内元件的一部分, 所有的EMC测试都将测试样品安装在一个厚度1mm, 长360mm*宽360mm的金属铁板上测试。 电源需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。有关EMC测试操作指导, 请参阅“组件电源供应器的EMI测试”。(在明纬网站http://www.meanwell.com) 5. 为应对EMI, 安装孔M1和M2应接地。 6. 散热片HS1,HS2不能短路。 7. 接触电流测量方法: 从初级输入到直流输出。									

■ 机构尺寸

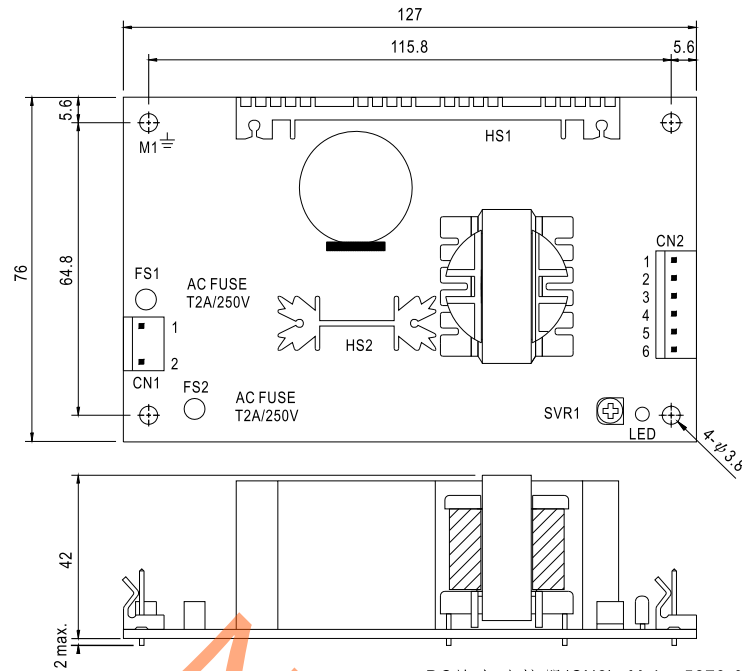

单位:mm

AC交流输入连接器(CN1): Molex 5277-02或同等级品

引脚编号	引脚功能	对应连接器	端子
1	AC/L	Molex 5195 或同等级品	Molex 5194 或同等级品
2	AC/N		


DC输出连接器(CN2): Molex 5273-06或同等级品

引脚编号	引脚功能	对应连接器	端子
1	+V	Molex 5195 或同等级品	Molex 5194 或同等级品
2,3	+5V		
4,5	COM		
6	-V		


≡: 接地要求

- 1.HS1,HS2不能短路
- 2.M1是安全地

■ 方框图

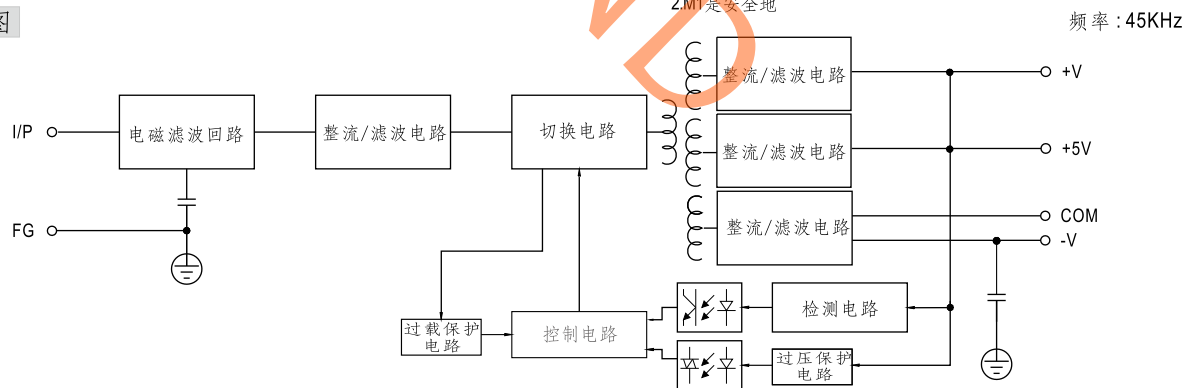

■ 减额曲线

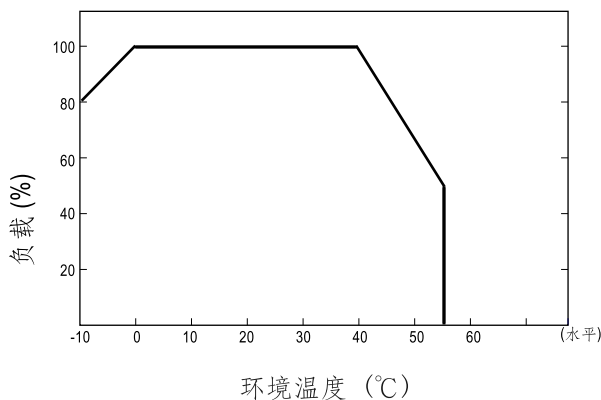

■ 静态特性曲线

